


15.10.2019 г.

Исх. №1510/19-1

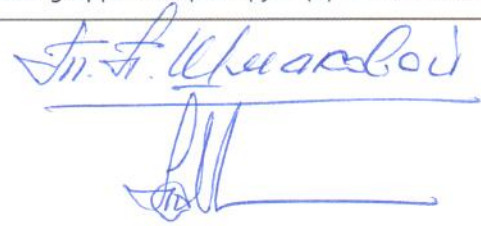

*А. Н. Звереву*  
*получен 22.10.2019*  
*в 10:40 утра.*  
*Иванов 15.10.2019*

**В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Омской области**  
644043, г. Омск, просп. Карла Маркса, 12а

**Уполномоченный орган:**  
**Казенное учреждение омской области "**  
**Центр по осуществлению закупок товаров,**  
**работ, услуг в сфере здравоохранения"**

Почтовый адрес: 644043 г. Омск, ул. Чапаева, д. 71  
Место нахождения: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, литер а, помещение 2  
Электронная почта: zakupzdrav-omsk@minzdrav.omskportal.ru  
тел.: (3812) 357-000

**Заказчик:**  
«Бюджетное учреждение здравоохранения омской области  
"Клинический онкологический диспансер"»  
644013, Омская обл., г. Омск Завертяева, 9 корпус 1  
Электронная почта: esonom\_om\_onkol@mail.ru  
тел.: (3812) 98-92-44

**Участник**  
**ООО «АРИС ГРУПП»**  
644052 г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 218 корп. 1  
Электронная почта: [info@aris-omsk.ru](mailto:info@aris-omsk.ru)  
тел.: (3812) 62-54-45


### ЖАЛОБА

на действия уполномоченного органа при рассмотрении первых частей заявок участников и при подведении итогов по результатам электронного аукциона на поставку **стола операционного хирургического многофункционального по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями"**, извещение от 25.09.2019 № 0852500000119001973

Закупка № 0852500000119001973

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной  
"Интернет"<http://www.rts-tender.ru>

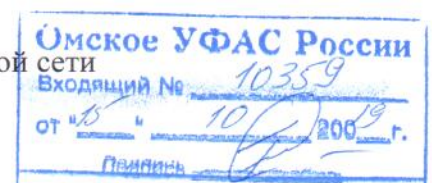

15

Заказчик: «Бюджетное учреждение здравоохранения омской области "Клинический онкологический диспансер"»

Место нахождения Заказчика: 644013, Омская обл., г. Омск Завертяева, 9 корпус 1

Адрес электронной почты Заказчика: [esonom\\_om\\_onkol@mail.ru](mailto:esonom_om_onkol@mail.ru)

Номер контактного телефона Заказчика: 83812989244

Наименование объекта закупки: Поставка стола операционного хирургического многофункционального по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Организация, осуществляющая размещение: Казенное учреждение омской области "Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения"

Почтовый адрес организации, осуществляющей размещение: 644043 г. Омск, ул. Чапаева, д. 71

Место нахождения организации, осуществляющей размещение: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, литер а, помещение 2

Ответственное должностное лицо организации, осуществляющая размещение: Руденко Полина Викторовна

Адрес электронной почты организации, осуществляющая размещение: [zakupzdrav-omsk@minzdrav.omskportal.ru](mailto:zakupzdrav-omsk@minzdrav.omskportal.ru)

Номер контактного телефона организации, осуществляющая размещение: 83812357000

Дата и время начала подачи заявок: 25.09.2019 14:41

Дата и время окончания подачи заявок: 03.10.2019 09:00

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 04.10.2019

Дата проведения аукциона в электронной форме: 07.10.2019

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 375 649,55

Валюта: Российский рубль

Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений. КБК 006 09.09 0000000000 244 , мероприятие 000000, бюджетное ассигнование , СубКОСГУ 3100299, тип средств 430000

#### **Доводы жалобы:**

25 сентября 2019 года на портале [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и электронной торговой площадке [www.rts-tender.ru](http://www.rts-tender.ru) был объявлен электронный аукцион на поставку стола операционного хирургического многофункционального по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями", извещение от 25.09.2019 № 0852500000119001973, идентификационный код закупки (ИКЗ): 192550302559355030100101340200000000.

04 октября 2019 года был опубликован протокол №194990/1 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в соответствии с которым были допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона две заявки участников. 07 октября 2019 года состоялся электронный аукцион, по результатам которого в соответствии с протоколом № 194990/2 подведения итогов электронного аукциона победителем был признан участник с идентификационным номером заявки 105952488 - ООО «Медицинские диагностические системы», с которым Заказчик обязан заключить государственный контракт.

Однако, имея значительный опыт работы на рынке медицинского оборудования, мы с большой долей уверенности можем заявить, что первая часть заявки победителя данного аукциона — ООО «Медицинские диагностические системы» содержала **недостоверную информацию**, не

соответствуя по ряду показателей медико-техническим характеристикам, указанным в описании объекта закупки (Приложение №1 к разделу II документации об электронном аукционе «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам») и, таким образом, **должна была быть отклонена** на основании п 6.1 статьи 66 Федерального закона от 50.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проанализировав поставки операционных столов компанией ООО «Медицинские диагностические системы», мы обнаружили заключенные контракты указанной компании по закупке № 0129200005319001671 (извещение от 21.05.2019), размещенной уполномоченным органом в качестве организатора совместного аукциона «Комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области», с Заказчиками:

**Государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника № 18"**

Реестровый номер контракта 2344390073619000036

Номер контракта 17ЭА-2019

**Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника № 3"**

Реестровый номер контракта 2344101993119000038

Номер контракта 1671

**Государственное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника № 6"**

Реестровый номер контракта 2344500784919000033

Номер контракта 24/19

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камышинская детская городская больница"**

Реестровый номер контракта 2343600314019000171

Номер контракта 299963

Во всех четырех заключенных контрактах брендом операционного стола является «DST» производства «Шандонг Юда Медикал Эквипмент Ко., Лтд», страна происхождения «Китай». Проанализировав регистрационную документацию на сайте «Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», можно сделать вывод, что операционные столы марки «DST» поставляются в Российской Федерации в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН 2013/25 от 08.02.2013. Принимая во внимание описание объекта закупки № 0852500000119001973, а также внешний вид столов марки «DST», можно сделать вывод о том, что данным характеристикам соответствует модель стола DST-III.

По нашему мнению, особое внимание привлекают следующие задекларированные параметры, явно противоречащие техническим характеристикам столов «DST», а именно:

№п/п	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значения показателей	Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145.	Характеристики операционного стола DST-III производства «Шандонг Юда Медикал Эквипмент Ко., Лтд»
1.4	Ширина панели:				
1.4.1	Диапазон номинальных значений	мм	Не менее 580 и не более 600*	ГОСТ Р 56107-2014 (п. 6.2.3)	520
1.5	Ширина стола по рейкам (для столов с шириной				

	500 мм):				
1.5.1	Номинальная	мм	Не менее 540 и не более 550*	ГОСТ Р 56107-2014 (п. 6.2.4)	590
1.11.1	Диаметр колеса	мм	Не менее 125*	Позволяют легко передвигать стол на мягком или неровном покрытии	100
1.12	Фиксация стола с помощью педали в основании стола со стороны головы пациента		Соответствие	Фиксация для предотвращения самопроизвольного перемещения стола во время оперативного вмешательства.	Со стороны ног, с правой стороны
1.16	Система соединения съемных головной и ножной секции		Штырьковая со стопорными защелками	Простота и надежность в использовании. Легко фиксируется, не нужно тратить много времени, в случае проведения срочных операций.	Винт
1.17	Пластиковая защитная вкладка разъемов соединения		Наличие	Необходима для защиты от влаги и пыли, создает герметичность	Нет
1.24	Высота стола				
1.24.2	- в крайнем верхнем положении	мм	Не более 950*	ГОСТ Р 56107-2014 (п.6.2.1)	1000 (+20)
1.27.2	Управление		Рычаг на всю ширину секции	Необходим в ножной секции для более правильного и удобного положения ног при проведении гинекологических и урологических операций	Нет

**В качестве доказательств нами были собраны следующие материалы и документы:**

I. Информация из открытых источников и сети «интернет», в том числе сайт производителя медицинского изделия:

1. оригинальный сайт компании производителя медицинского изделия

на английском языке: <http://www.yudamed.com/surgical-table/operating-table/surgical-operation-table.html#F1>

на русском языке: <http://ru.yudamed.net/surgical-table/operating-table/radiolucent-operating-surgical-table.html>

<http://ru.yudamed.net/surgical-table/operating-table/hydraulic-operation-theatre-table.html>

На официальном сайте производителя на английском языке «Шандонг Юда Медикал Эквипмент Ко., Лтд» в соответствии со ссылкой на модель стола DST-III находит подтверждение информация по пункту 1.24.2, так, например, в описании параметров указано:

**maximum height: 1020mm (40.1in)**

**Данный факт говорит о том, что максимальная высота стола составляет 1020 мм, что противоречит требованиям пункта 1.24.2 (не более 950\*мм).**



Эта же информация подтверждается на русскоязычной версии сайта (по обеим ссылкам, по одной из них указан допуск по максимальной высоте 1000±20 мм). Выбрав в каталоге нужную модель стола DST-III, видим, что в графе «Особенности» указан параметр:

**«6. Высота: 660-1000 мм (26-40,1 дюйма)»**

Далее обратимся к внешнему виду стола, по фото на официальном сайте производителя как на английском языке, так и на русском, присутствуют фотографии операционного стола, исходя из которых можно подтвердить несоответствие описания стола по пункту 1.16. На фото отчетливо

видно, что система соединения как минимум съемной головной секции выполнена с использованием винта, а не стопорных защёлок.


К тому же на приведенных ниже фотографиях можно заметить, что описанная в п. 1.12 фиксация стола с помощью педали в основании стола со стороны головы пациента на рассматриваемых столах находится со стороны ножной секции слева относительно пациента, выполнена в виде стопора с красной и зеленой окраской.

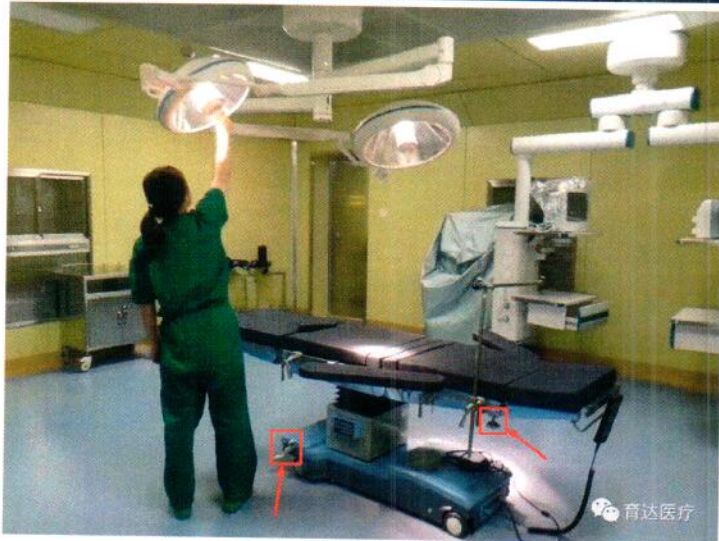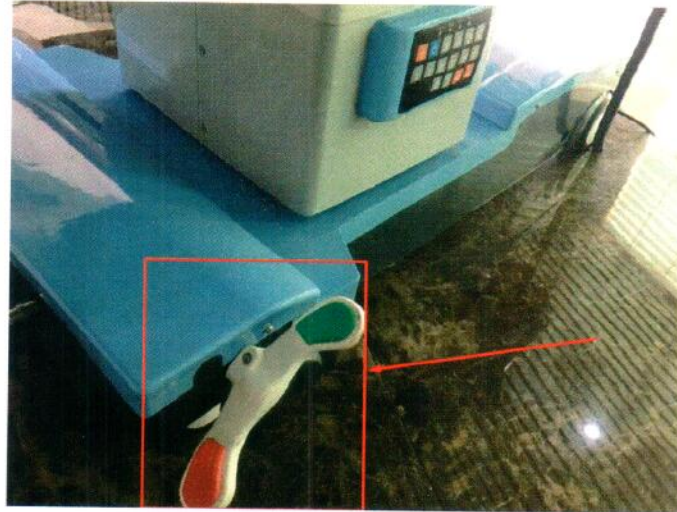


2. Сайт прямого импортера операционных столов в Российскую Федерацию (Представительство завода "Yuda Group")

<http://yudamedrus.ru/shop/product/operatsionnyy-stol-dst-iii>

На сайте официального представителя подтверждается фотографиями наличие винтов крепления, но уже не только головной секции, на данном фото виден винт крепления ножной секции, выделен дополнительно упор фиксации со стороны ножной секции. К тому же, отсутствует описанная в п. 1.17 пластиковая защитная вкладка разъемов соединения, её нет на выделенных винтах.

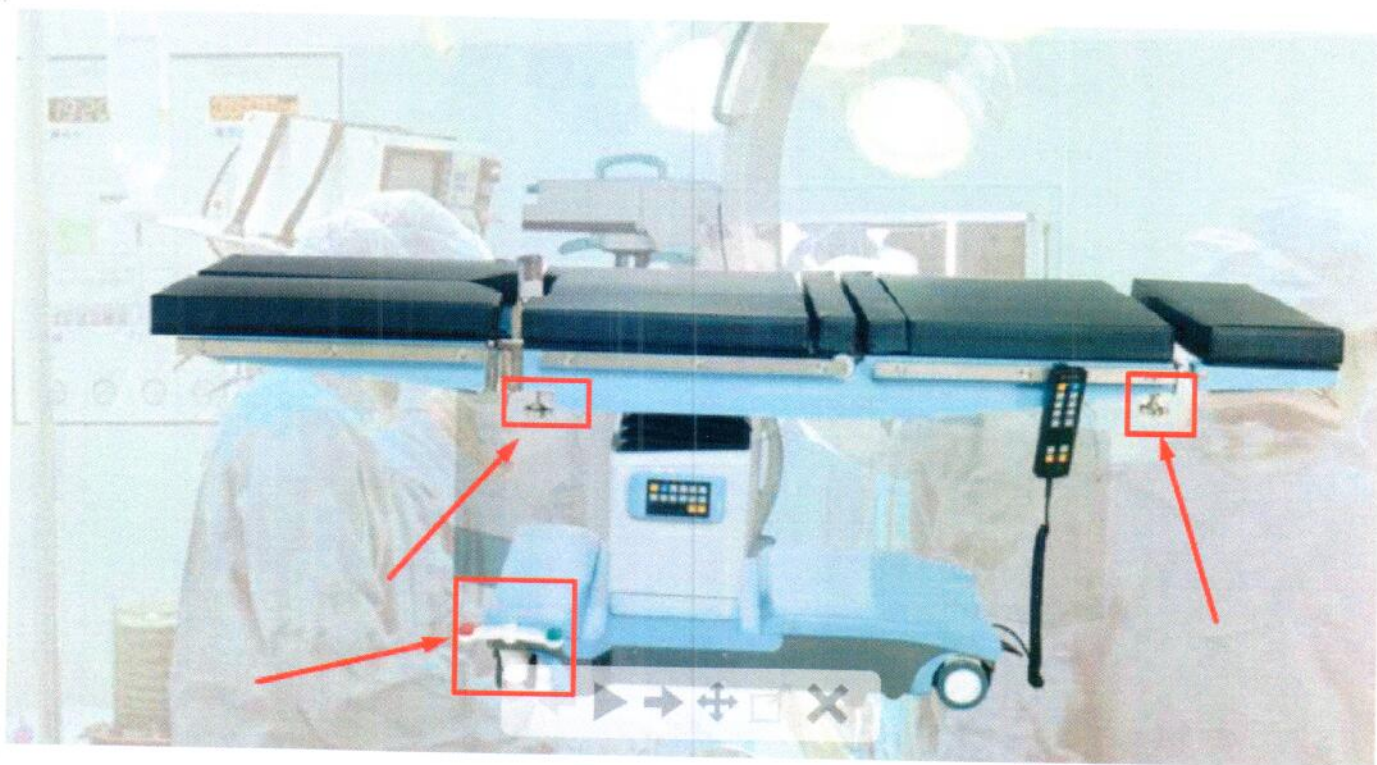

На всех приведенных выше изображениях отсутствует описанный в п. 1.27.2 рычаг на всю ширину секции, расположенный в ножной секции. Данный рычаг во всю длину присутствует, например, в столе операционном MerivaaraPractico и выглядит следующим образом:

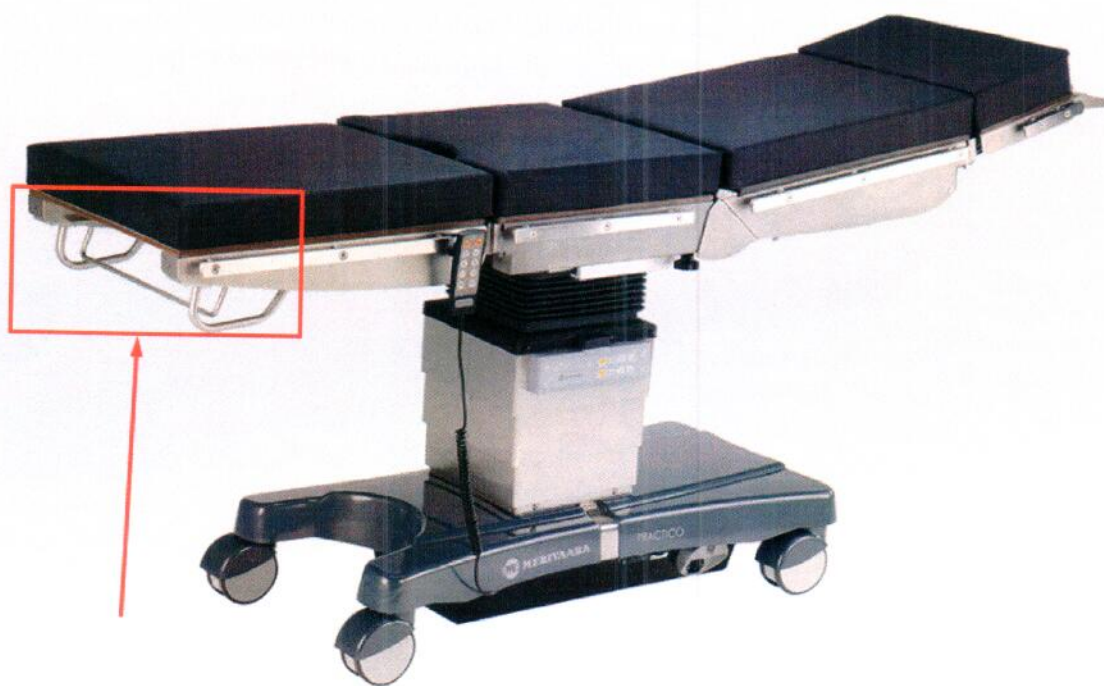

3. Сайты дистрибьюторов операционных столов марки DST:

- <https://euosmed.ru/products/operatsionnyj-stol-dst-iii>
- [https://rosopeka.ru/catalog/operatsionnyy\\_stol\\_dst\\_iii\\_art\\_umr23314.html](https://rosopeka.ru/catalog/operatsionnyy_stol_dst_iii_art_umr23314.html)
- <https://www.me-d.ru/shop/3267/desc/stol-operacionnyj-s-ehlektrohidravlicheskimi-regulirovkami-osnovnykh-funkcij-s-batarejnym-pitaniem-na-rolikakh-dst-iii>
- <http://medec.ru/catalog/operatsionnye-stoly/stol-operatsionnyy-dst-iii/>
- <http://операционный-стол.рф/operatsionnye-stoly-katalog/stol-operatsionnyy-lektrohidravlicheskiy-model-dst-iii-dlya-lapa>

По приведенным выше ссылкам подтверждается несоответствие предоставленной участником закупки информации по пунктам:

- 1.4 Ширина панели:
  - 1.4.1 Диапазон номинальных значений
- 1.5 Ширина стола по рейкам (для столов с шириной 500 мм):
  - 1.5.1 Номинальная
- 1.11.1 Диаметр колеса
- 1.15 Количество съемных элементов панели стола
- 1.24 Высота стола
  - 1.24.2 - в крайнем верхнем положении

II. Информация из официального паспорта медицинского изделия, заверенного печатью производителя (в приложении к тексту жалобы), также подтверждает расхождение как минимум в 2х размерах (Раздел паспорта №13, технические характеристики и схемы, стр. 42,43):

Ширина (модель DST-III)  $540 \pm 20\text{mm}$   
Максимальная высота (модель DST-III)  $1000 \pm 20\text{mm}$

**несоответствие с пунктами описания 1.4, 1.4.1; 1.24, 1.24.2.**

III. Информация из «Единой информационной системы» также подтверждает несоответствие характеристик операционного стола описанию рассматриваемой закупки.

**1. Закупка № 0158200001319000529**

Заказчик - МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Реестровый номер контракта 2616304981419000469  
Номер контракта 19000529

Наименование оборудования	Стол операционный DST
Наименование производителя	«Шандонг Юда Медикал Эквипмент Ко., ЛТД»
Модель	<b>DST-III</b>
<b>Высота стола в крайнем верхнем положении (без подушек), мм,</b>	<b>1030 мм</b>
<b>Ширина панели, номинальное значение, мм</b>	<b>520 мм</b>

**2. Закупка № 0320300064518000044**

Заказчик - КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАРТИЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"  
Реестровый номер контракта 2250900058218000055  
Номер контракта 0320300064518000044-0219913-02

N п/п	Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)
1	2

1.	Стол операционный универсальный (Модель DST-III)
----	--

Наименование товара, его показатели	Требуемое значение показателей	Наименование товара, его показатели
Ширина панели стола (без боковых рельс), не менее	530 мм	535 мм

**Просим Комиссию УФАС:**

1. Приостановить процедуру заключения контракта по результатам электронного аукциона № 0852500000119001973.
2. Отменить протокол подведения итогов электронного аукциона № 194990/2 от 10.10.2019.
3. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 194990/1 от 04.10.2019.
4. Вернуть закупку № 0852500000119001973 на этап рассмотрения первых частей заявок.

**Приложение к жалобе:**

1. Копия решения о продлении полномочий директора *на 1 месяц*
2. Паспорт на операционный стол «DST», заверенный печатью производителя (на 46 листах)

Директор \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Кошкарбаев А.О.